

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО ФМБА РОССИИ

Лукичев С.П.



Врач-дезинфектолог
ФГБУЗ ГЦ ГиЭ ФМБА России


Основные эпидемиологические факторы риска в эндоскопических и эндохирургических подразделениях медицинских организаций

- **Обеспеченность химическими средствами дезинфекции и стерилизации;**
- **Обоснованность выбора и применения ДС;**
- **Обеспеченность специальными МДМ для обработки эндоскопов;**
- **Обеспеченность специальными шкафами для хранения эндоскопов;**
- **Обеспеченность специальными расходными материалами (газовые фильтры для инфуффляторов, стерильные покрытия для видеокамер, экстракционные пакеты, ирригационные и аспирационные трубки).**


**Гнойно-септические и другие инфекционные
осложнения при эндоскопических
оперативных вмешательствах по данным за
2016 г.
(МО ФМБА России)**

0

Фактическое и расчетное количество ДС и МС, используемое для обработки гибких ЭНДОСКОПОВ (62 МО ФМБА России, 2017г.)

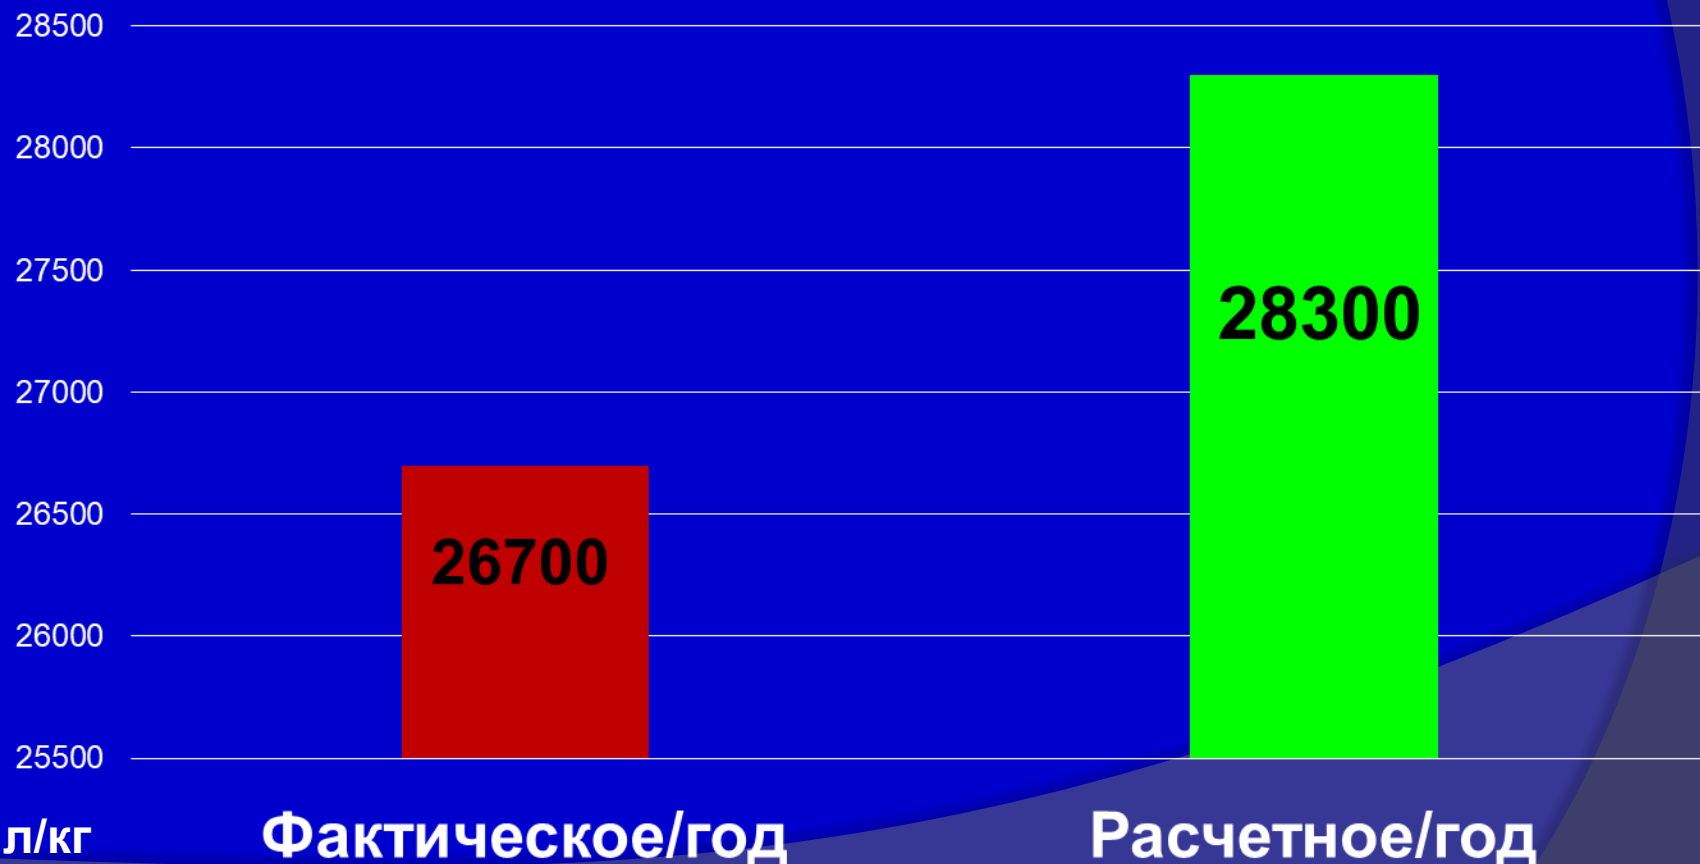

Структура расчетного количества ДС и МС для обработки гибких эндоскопов (62 МО ФМБА России, 2017г.)

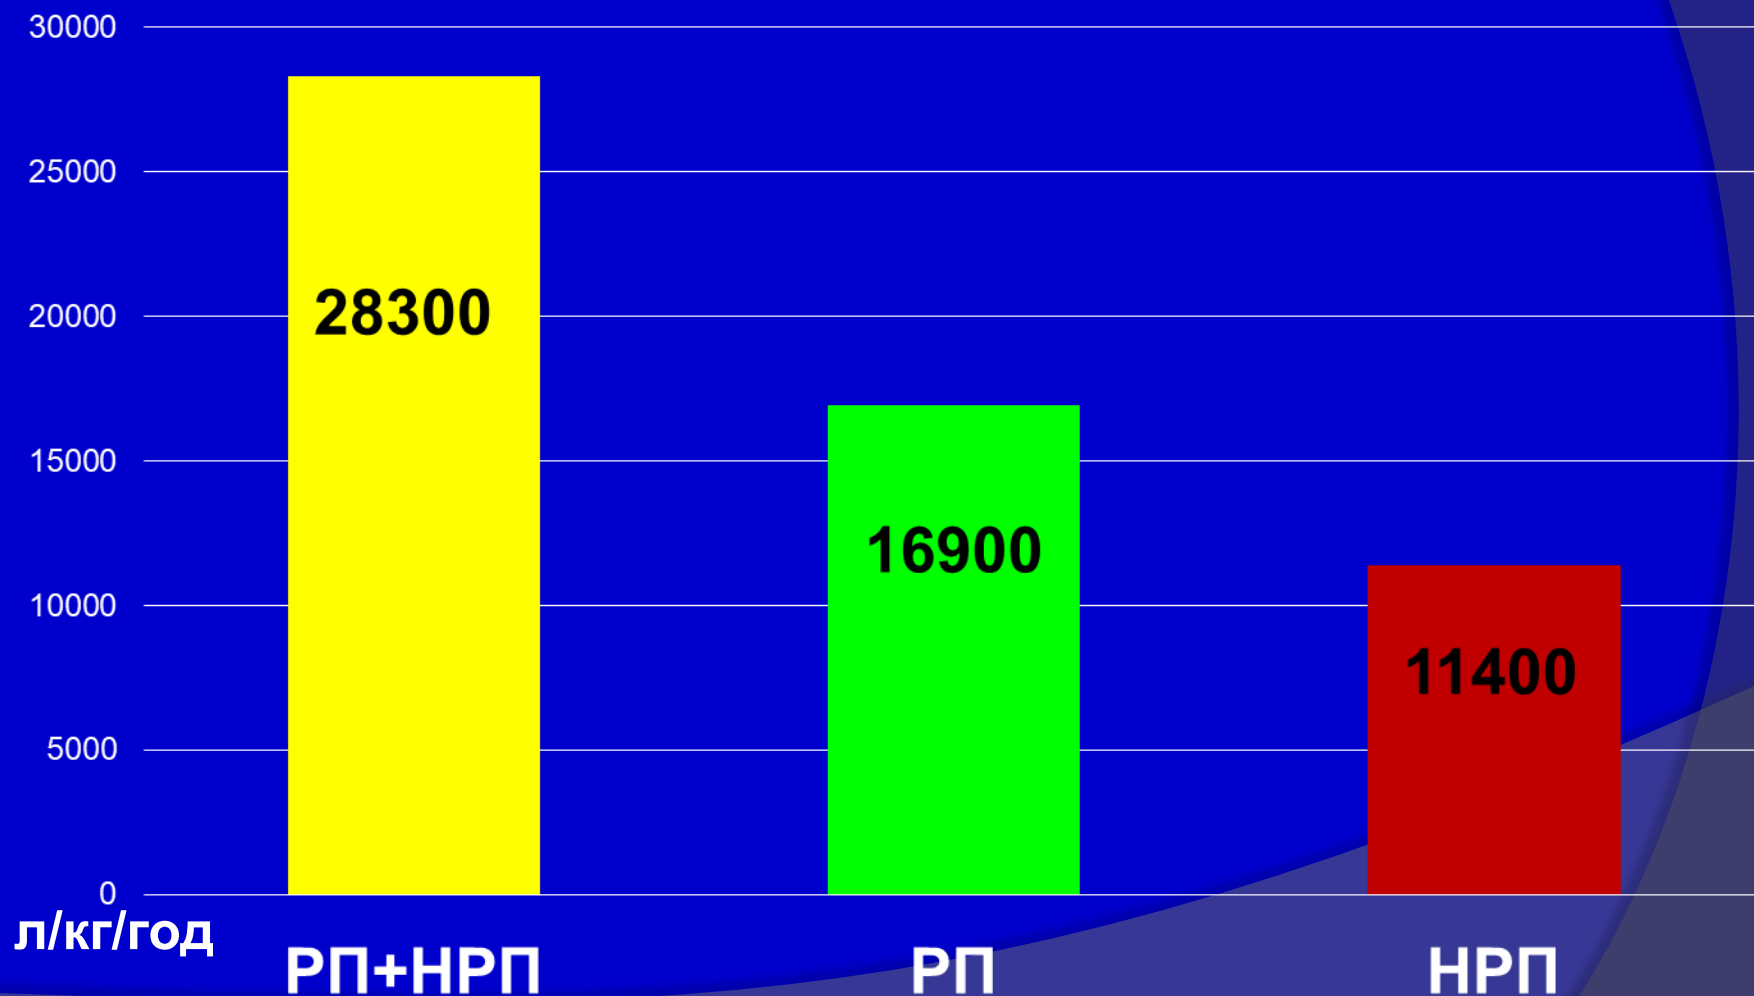


Потребность МО в рекомендованных ДС и МС для обработки гибких эндоскопов (62 МО ФМБА России, 2017)

Наименование средства	Потребность
1. Сайдекс ОПА	8705 л
2. Сайдекс	2940 л
3. Сайдезим	1885 л
4. Асесайд (875 мл)	320 л (366 фл)
5. Эндоквик (980 мл)	632 л (644 фл)
6. Стераниос 20%	335 л
7. Секусепт Актив	2077,5 кг
<u>ВСЕГО</u>	<u>16 900 л/кг</u>

ДС и МС, используемые для обработки гибких эндоскопов в МО ФМБА России (62 МО ФМБА России, 2017г.)

Всего препаратов - 83

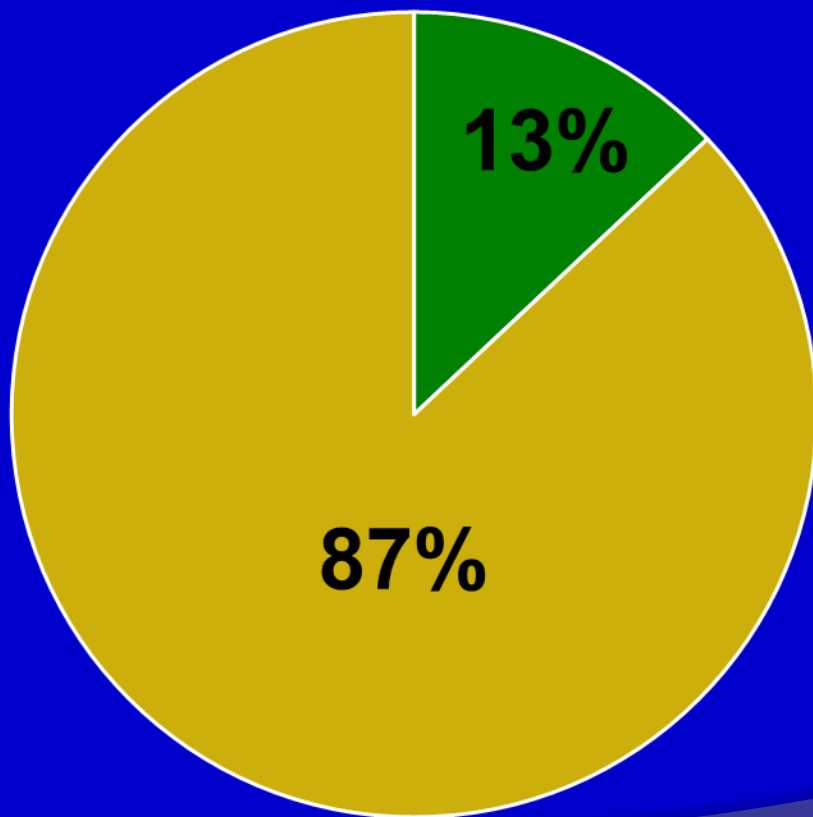


■ Рекомендованных - 11

■ Нерекомендованных - 72


ДС и МС, используемые для обработки жестких эндоскопов в МО ФМБА России (52 МО ФМБА России, 2017г.)

Всего препаратов - 99

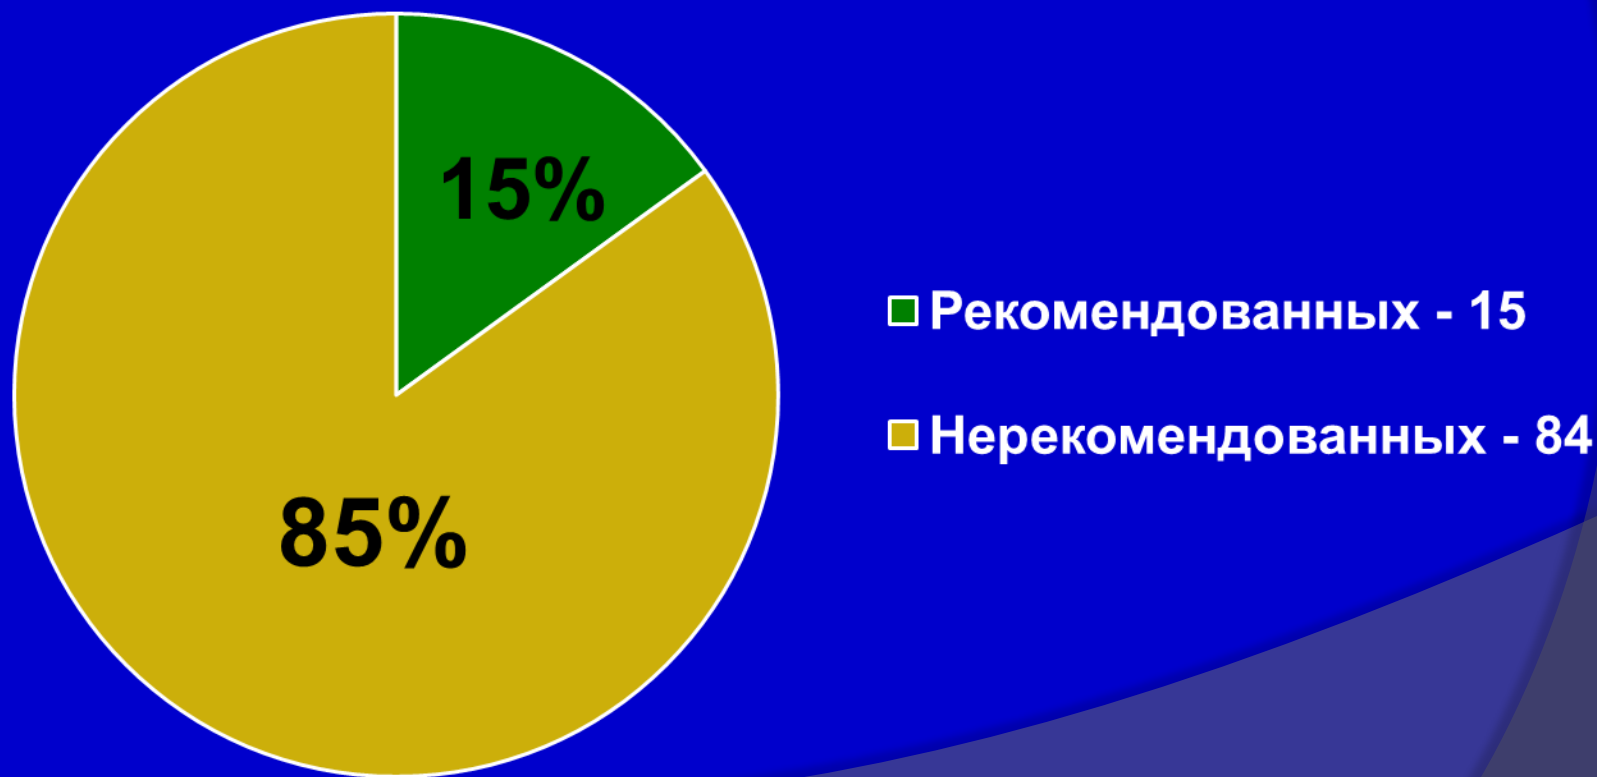

**Количество торговых наименований ДС и
МС, используемых для обработки
эндоскопического оборудования (62 МО ФМБА
России, 2017 г.)**

Всего 119

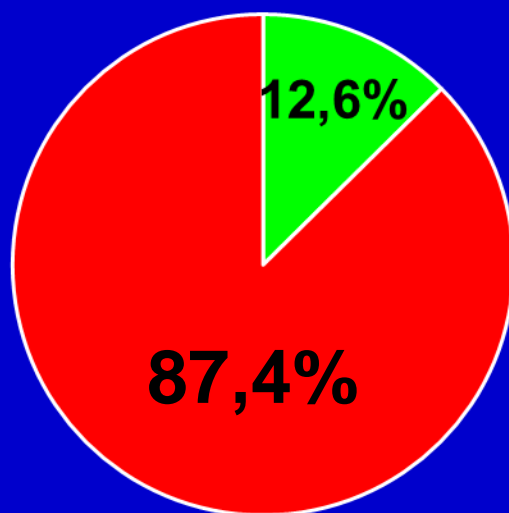


■ Рекомендованных - 15

■ Нерекомендованных - 104


Соотношение МО ФМБА России применяющих ДС и МС для обработки гибких ЭНДОСКОПОВ (по данным 62 МО, 2017г.)

Всего МО - 62

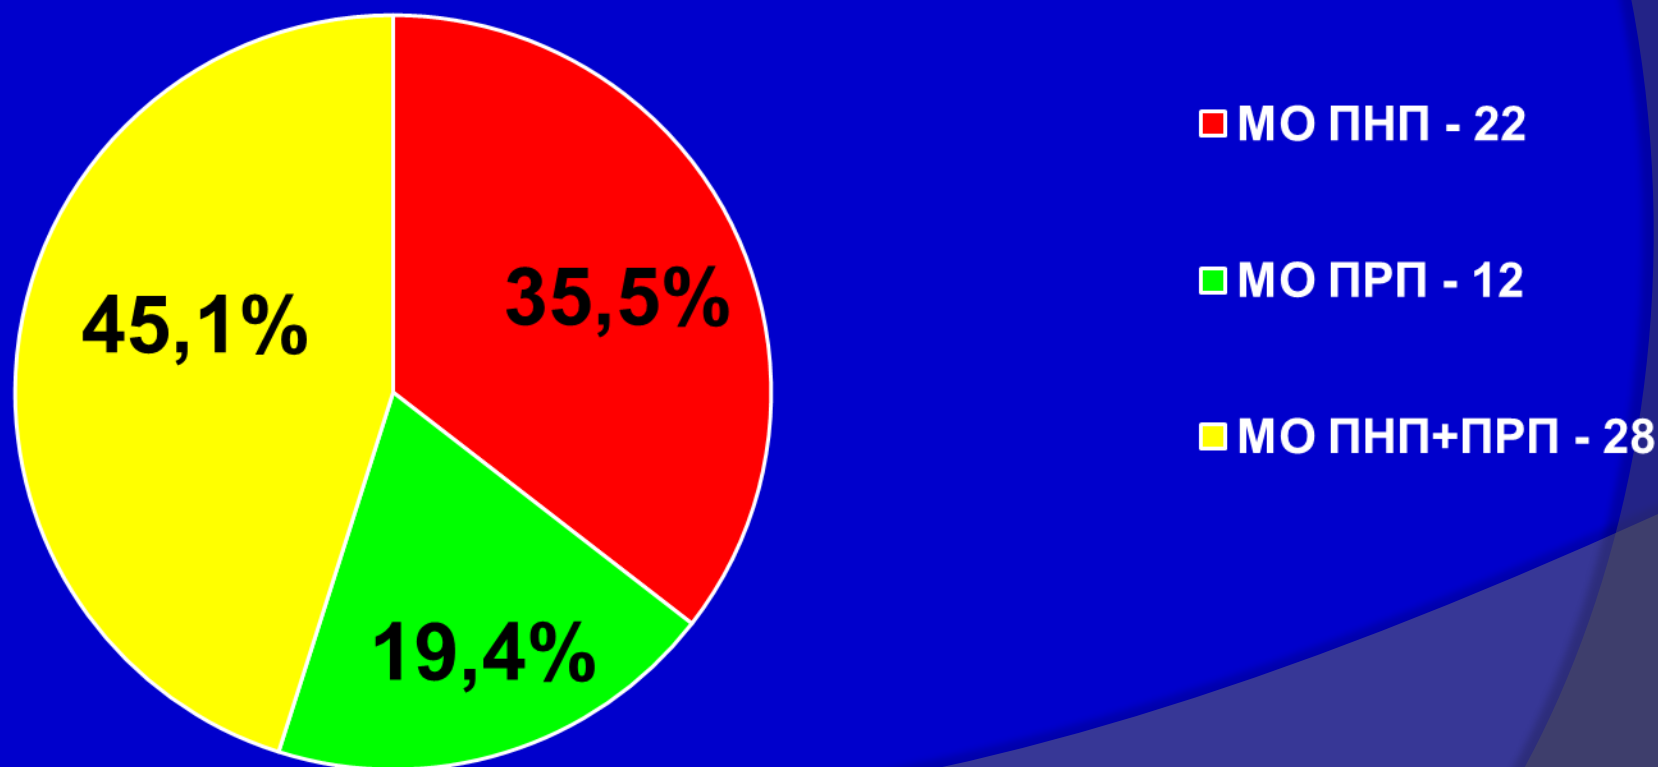


Контрактные цены на Сайдекс (5л) за 2016

Г. (по данным 62 МО ФМБА России)

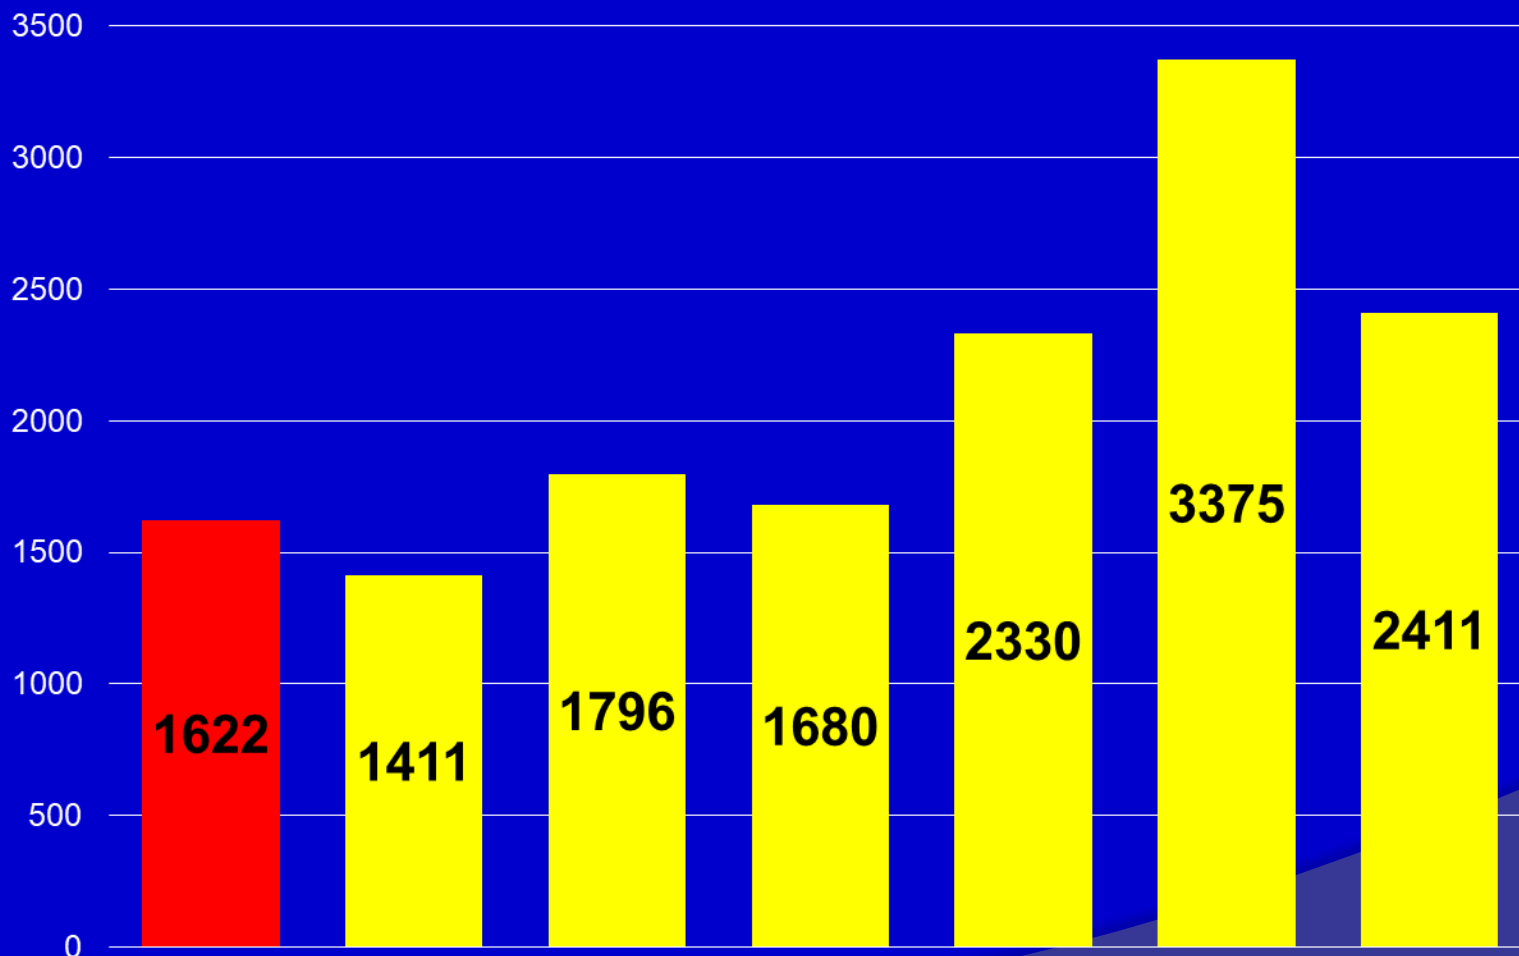


 - рекомендованная цена производителя руб/канистра

Контрактные цены на Сайдекс ОПА (3,78л) за 2016 г. (по данным 62 МО ФМБА России)

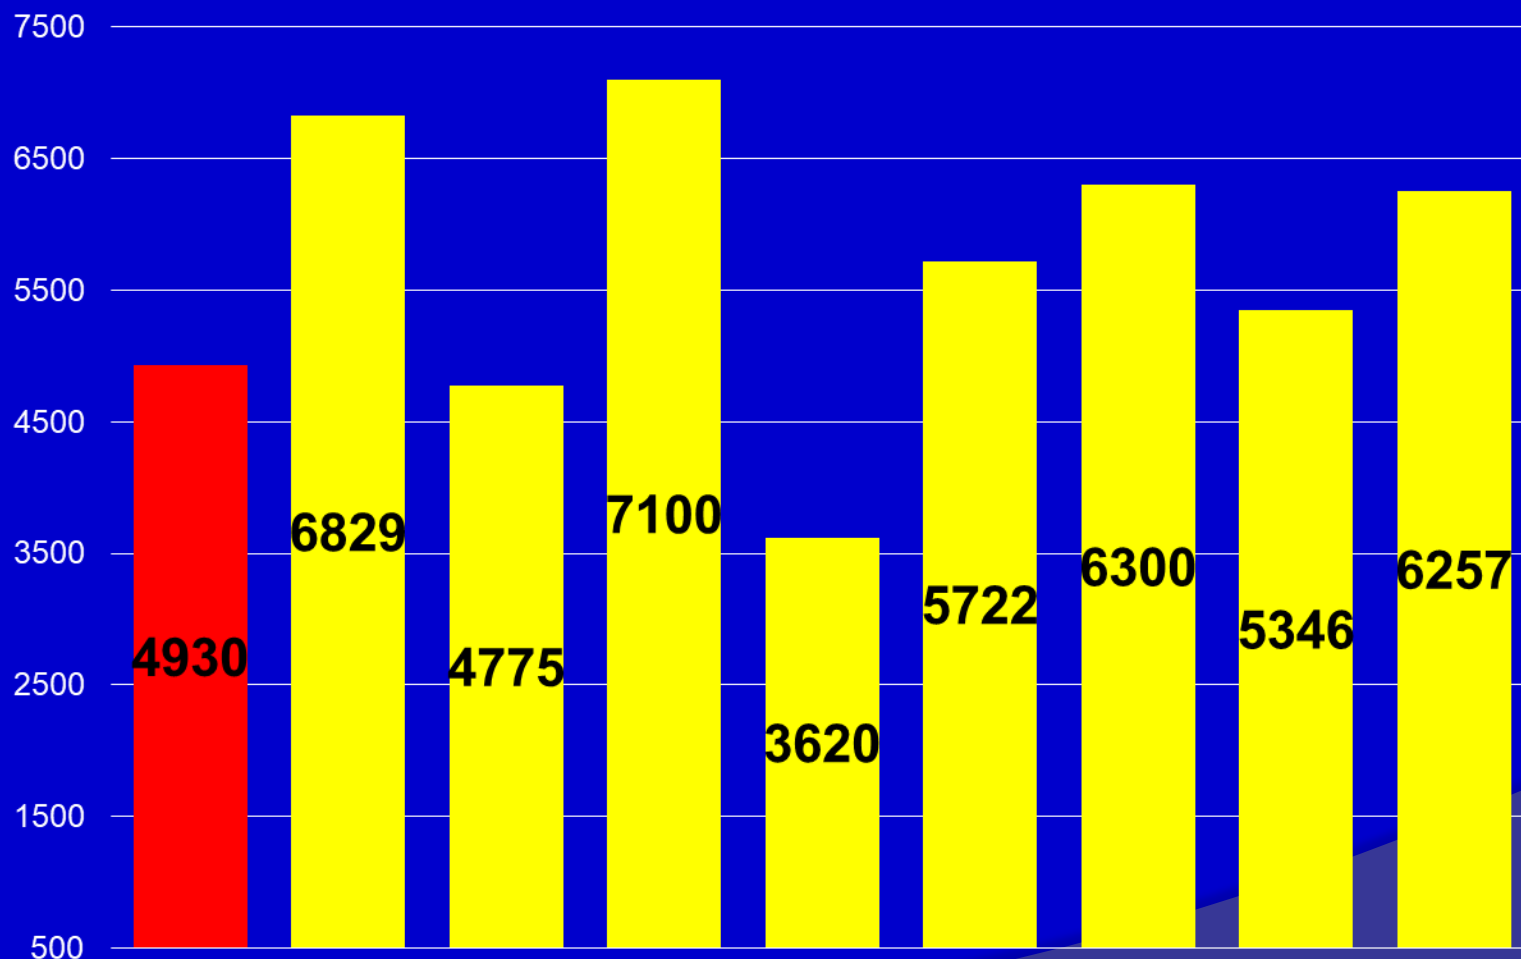


 - рекомендованная цена производителя руб/канистра

Контрактные цены на Сайдезим (5л) за 2016 г. (по данным 62 МО ФМБА России)

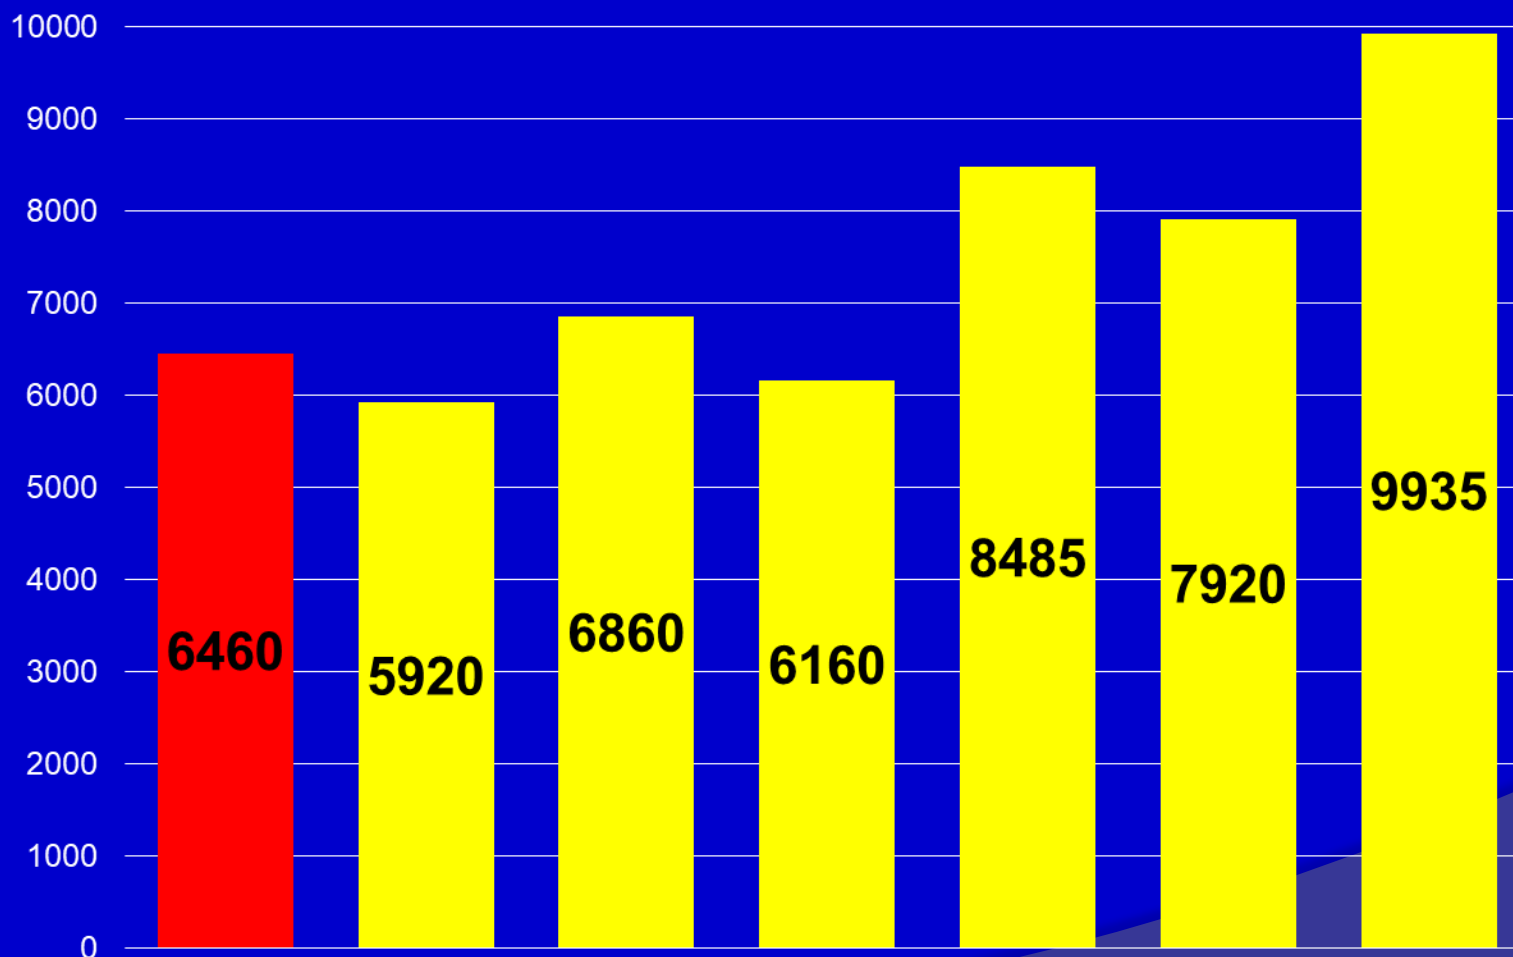


 - рекомендованная цена производителя руб/канистра

Контрактные цены на Секусепт Актив (1,5 кг) за 2016 г. (по данным 62 МО ФМБА России)

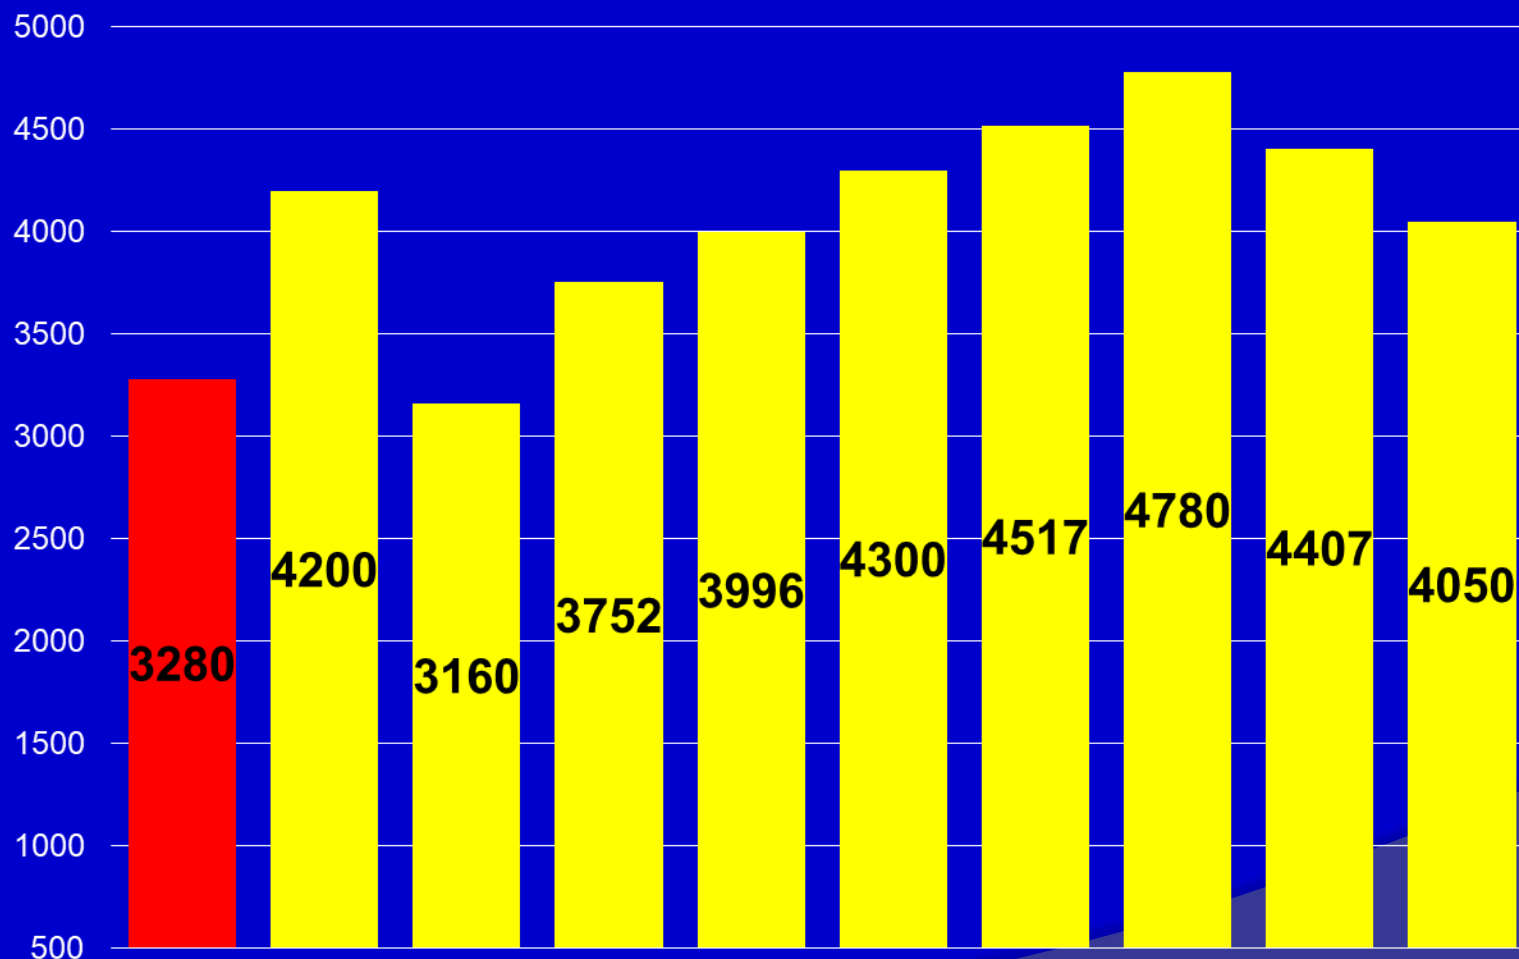

 - рекомендованная цена производителя руб/банка

Контрактные цены на Асесайд (875мл) за 2016 г. (по данным 62 МО ФМБА России)

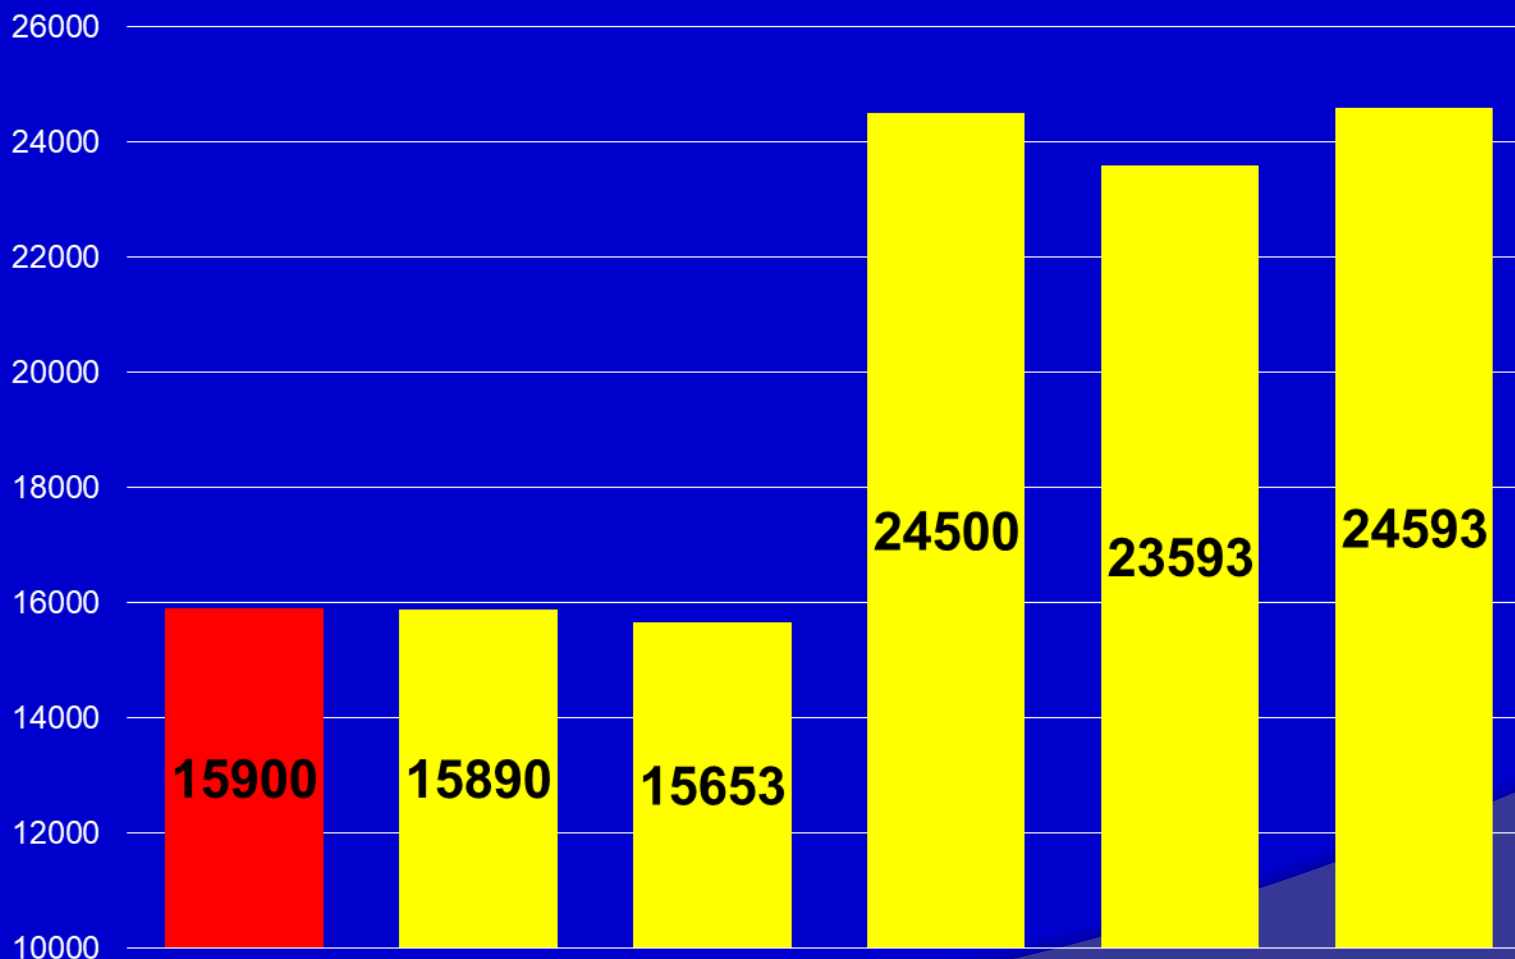


 - рекомендованная цена производителя руб/флакон

Денежные средства, затраченные в
2016 г. на закупку ДС и МС для
эндоскопического оборудования (по
данным 48 МО ФМБА России)

51 102 284,53 руб


МДМ, используемые в МО ФМБА России (по данным 43 МО, 2016г.)

Всего 143 единицы

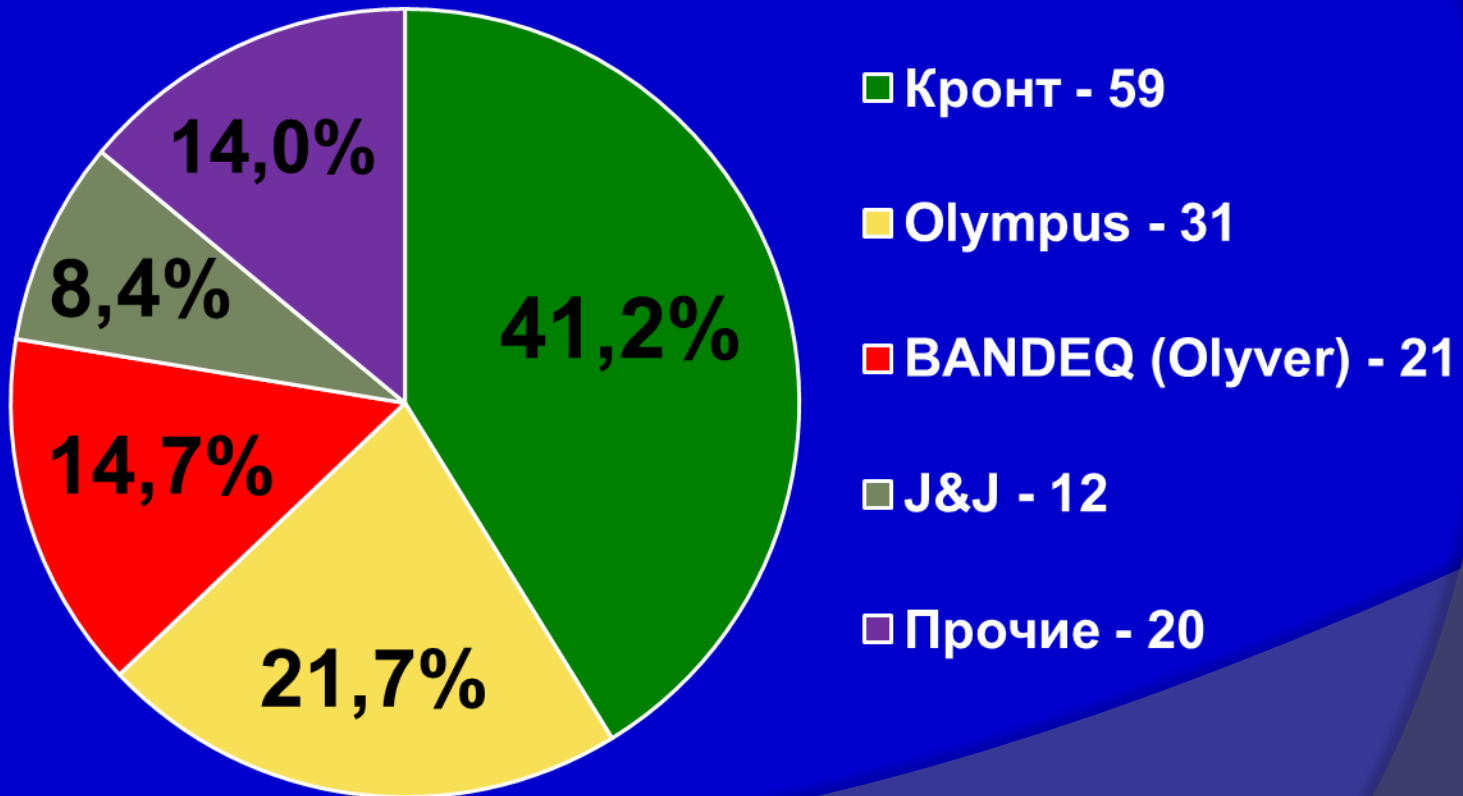

Потребность МДМ для гибких эндоскопов (62 МО ФМБА России, 2017 г.)

Всего 155 единиц

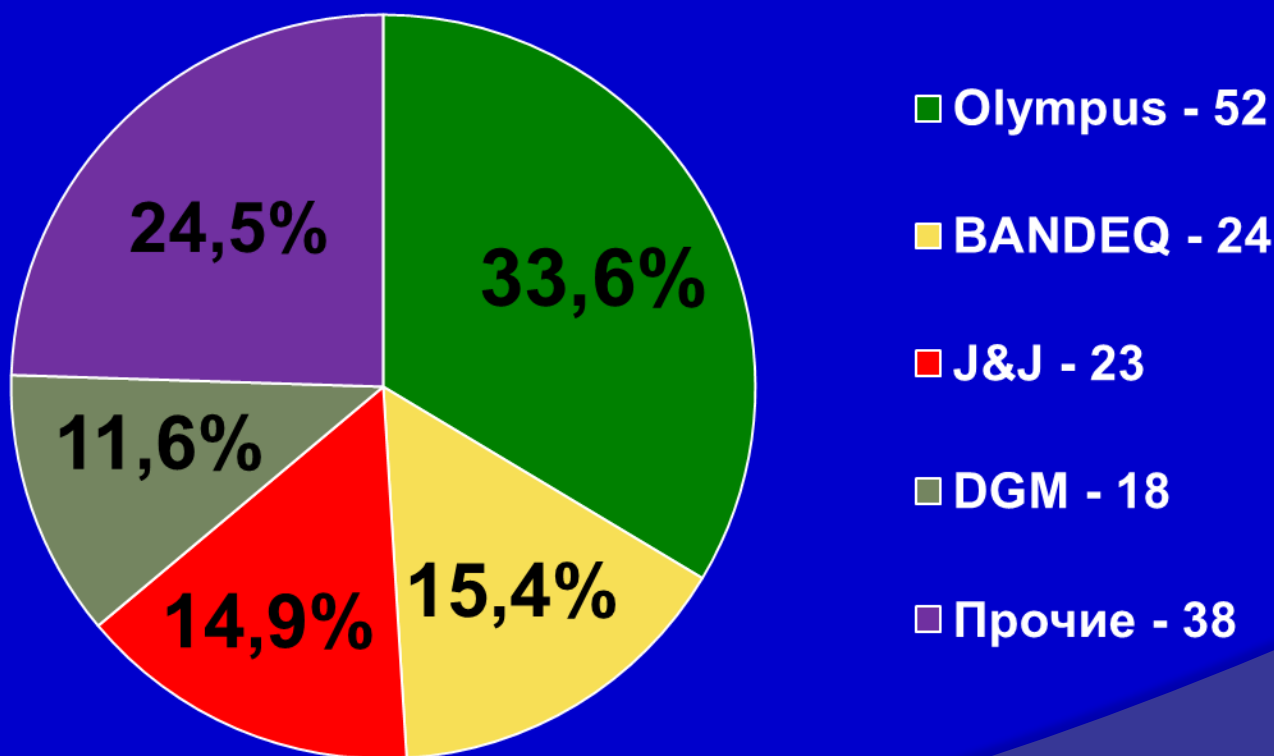

Заявленная потребность в оборудовании (по данным 62 МО ФМБА России, 2017 г.)

№	Наименование оборудования	Потребность	Примечание
1.	Моюще-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	155 шт.	87% МО
2.	Шкаф для хранения гибких эндоскопов	120 шт.	74% МО
3.	Эндохирургические стойки различного назначения (Карл Шторц)	37 шт.	24 МО
4.	Отдельное оборудование (Карл Шторц)	30 ед.	24 МО

Количество эндоскопических операций, проведенных в 2016 г. (52 МО ФМБА России)

№№	Операция	Количество
1.	Лапароскопические	18227
2.	Торакоскопические	389
3.	Артроскопические	3355
4.	Прочие	35040
	<u>Всего</u>	57011

Заявленная потребность в расходных материалах для эндохирургических операций (50 МО ФМБА России, 2017г.)

№	Наименование	Количество	Примечание
1.	Трубки для ирригации и аспирации	18590 компл.	57011 эндоскопических операций
2.	Покрытия для видеокамер (стерильные)	32170 шт.	57011 эндоскопических операций
3.	Газовые фильтры для инсуфляторов	15700 шт.	18227 лапароскопических операций
4.	Экстракционные пакеты	9060 шт.	

Благодарю за внимание

Лукичев Сергей Петрович
т. 8 916-194-74-25



ФГБУЗ ГЦ ГиЭ ФМБА России
ЦП ИСМП ФМБА России